


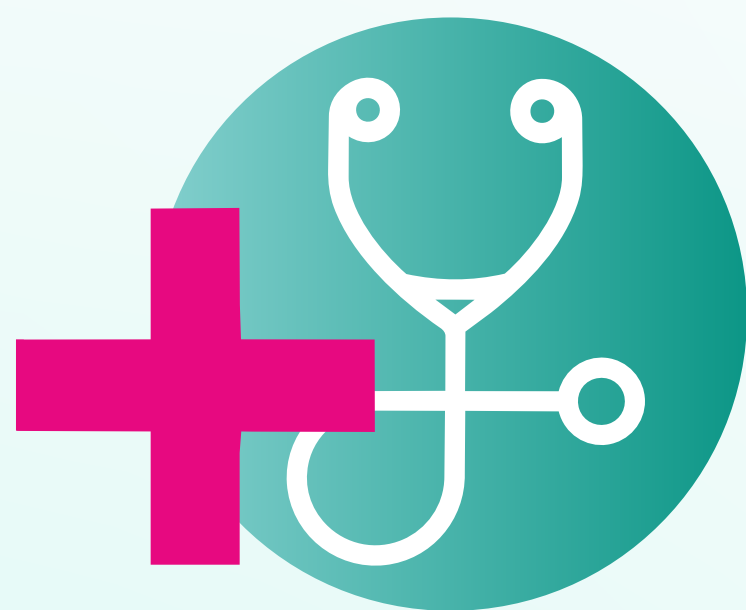

stetoskop

**MEDIA KIT  
2026.**

## UVOD

Ovaj media kit namenjen je partnerima, medijima i organizatorima koji predstavljaju brend Stetoskop info. Sadrži zvanične fajlove logoa, osnovna pravila upotrebe i podatke za kontakt. Molimo da se koristi isključivo ovaj materijal, bez izmena logoa. Svaku upotrebu u zajedničkom materijalu potrebno je prethodno odobriti.

## LOGO

Logo Stetoskop info koristi se isključivo u originalnom obliku, u skladu sa uputstvom u ovom dokumentu. Pre objave materijala u kome se pojavljuje naš logo, potrebno je poslati nacrt na odobrenje na [milica@stetoskop.info](mailto:milica@stetoskop.info). Logo se ne koristi tako da sugerise da Stetoskop info preporučuje proizvod, uslugu ili stav, osim ako je to izričito dogovoreno.



U ovom paketu nalaze se zvanične verzije logoa za digitalnu upotrebu. Koristite isključivo ove fajlove i **ne pravite sopstvene prerade.**

Horizontalni logo (znak + naziv): osnovna verzija, koristi se kad god ima mesta.

Znak: koristi se samo kada je prostor mali (profilna slika, ikonica), a naziv brenda je vidljiv u blizini.


Koji fajl za šta:

- PNG (providna pozadina): prezentacije, dokumenti, društvene mreže, mejlovi, baneri.
- SVG: sajtovi i aplikacije, jer ostaje oštar na svakoj veličini.

Fajlovi su u RGB režimu.


## BOJE BREND:

Gossamer #0a9889, Rough Turquoise #83cfcd, Wolf Gray #919495, Mexican Pink #e70980.  
Partneri ne moraju da koriste boje brenda.




**Gossamer**

Hex #0a9889  
RGB (10, 152, 137)




**Rough Turquoise**

Hex #83cfcd  
RGB (133, 208, 206)



**Wolf Gray**

Hex: #919495  
RGB (146, 149, 150)



**Mexican Pink**

Hex: #e70980  
RGB (231, 12, 129)

## DRUŠTVENE MREŽE

Za naslovne slike i objave koristi se horizontalni logo prema pravilima o postavljanju preko fotografije.

(PRAVILA: Kompozicija je jasna, sa jednim glavnim motivom i dovoljno slobodnog prostora. Poželjni su kadrovi sa svetlom, jednobojnom površinom koja omogućava postavljanje logoa i teksta. Preporučuje se pravilo trećina, a motiv se postavlja tako da ne zaklanja zonu predviđenu za logo (gornji ili donji levi ugao).

## VEB SAJT PARTNERA

Logo se na sajtu postavlja kao SVG ili PNG, sa linkom ka <https://www.stetoskop.info/> kada je u pitanju saradnja. Dodaje se opis slike (alt tekst): “Stetoskop info logo”. Logo ne sme da bude zamućen na ekranima visoke rezolucije.

## MEJL I NEWSLETTER


Koristi se PNG sa providnom pozadinom.

## FAVICON

Samo za sajt Stetoskop info. Partneri ga ne koriste.

## NEDOZVOLJENA UPOTREBA

Logo je ključni element identiteta i mora se primenjivati dosledno. Navedeni primeri prikazuju najčešće greške i nisu dozvoljeni. Pri svakoj primeni koristi se isključivo odobrena verzija logoa, preuzeta iz zvaničnih fajlova.

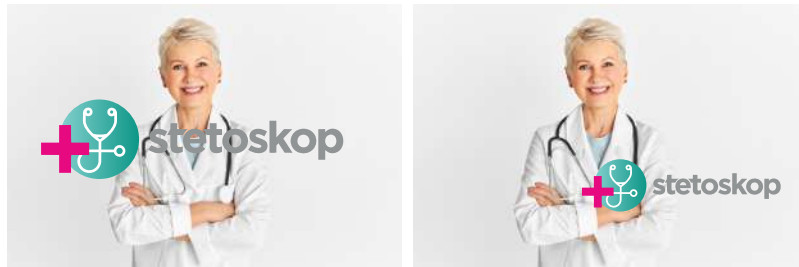

Logo se ne postavlja preko cele slike, niti preko delova fotografije na kojima se elementi preklapaju sa logoom. Postavlja se samo u definisanom položaju, na svetloj i jednobojujnoj površini.



Logo se ne postavlja preko gradijenata na kojima se gubi kontrast i čitljivost bilo kog njegovog dela. Logo se ne postavlja preko gradijenata koji ne pripadaju paleti brenda.



Logo se ne postavlja preko patterna, tekstura i šara, jer remete čitljivost i narušavaju jasnoću oblika.




Logo se ne sme razvlačiti, sabijati niti na bilo koji način deformisati. Pri skaliranju uvek se zadržavaju originalne proporcije (u Illustratoru držati Shift). Logo se ne rotira, ne naginje i ne postavlja pod uglom.



Boje logoa se ne menjaju, osim izmene tipografije u belu, kako je definisano u sekciji o pozadinama. Na logo se ne dodaju senke, odsjaji, konture (outline), providnost niti drugi efekti.

## PRIKAZ UZ DRUGI LOGO

Primer:

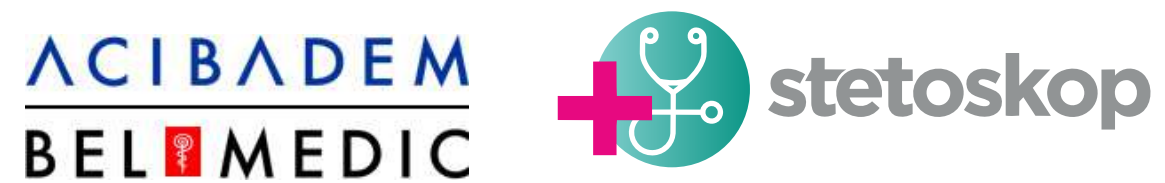

Kada se logo Stetoskopa prikazuje zajedno sa logoima partnera, sponzora ili drugih organizacija, mora ostati jasno izdvojen i čitljiv. Svaki logo zadržava svoj zaštitni prostor, a logoi se ne spajaju niti preklapaju.

Minimalni razmak između logoa jednak je [dvostrukoj visini slova "o" / zaštitnom prostoru], izmeren od ivica logoa. Razmak je jednak između svih logoa u nizu.

Logoi se skaliraju tako da deluju vizuelno ujednačeno. Logo Stetoskopa nikada nije manji od partnerskog logoa. Dozvoljeno je poravnanje gde je Stetoskop logo pored partnerskog i visina kruga se poklapa sa visiom partnerskog logoa, osim kada je drugačije definisano ugovorom ili događajem.

## LINK ZA SKIDANJE STETOSKOP LOGOA

<https://drive.google.com/drive/folders/1A4-SB9l29VSvcNChSo4o3nPDfPIZsGHf?usp=sharing>